

آنالایزر VOC - 3702

wifi/gsm/gprs




- دارای سنسور PID AH شرکت آلفاسنس انگلستان با محدوده اندازه گیری 0-50ppm
- گواهینامه کالیبراسیون از آزمایشگاه آکرو دیتته در غلظت 50ppm ایزو بوتیلن
- عدم نیاز به سخت افزار و نرم افزار جهت مشاهده داده ها
- امکان کالیبراسیون از طریق وای فای
- امکان کالیبراسیون از طریق پیامک ، بدون نیاز به حضور در محل لاگر
- امکان نصب بسیار ساده
- طراحی شده در بستر اینترنت اشیا
- نمایش لحظه ای VOC ، موقعیت مکانی، قدرت آنتن و شارژ باقیمانده سیم کارت
- امکان ارسال پیامک به مسئول فنی، بمحض رخداد شرایط نامطلوب
- آرشیو داده ها در سرور اصلی بدون نیاز به کارشناس IT
- مشاهده داده ها از طریق وای فای و تحت وب روی گوشی یا تبلت



www.EHYAGHAN.ir
telegram: @Ehyagran.co
+98 915 1211239

• ولتاژ ۲۲۰ ولت

• قیمت و پشتیبانی مناسب (یکسال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش)

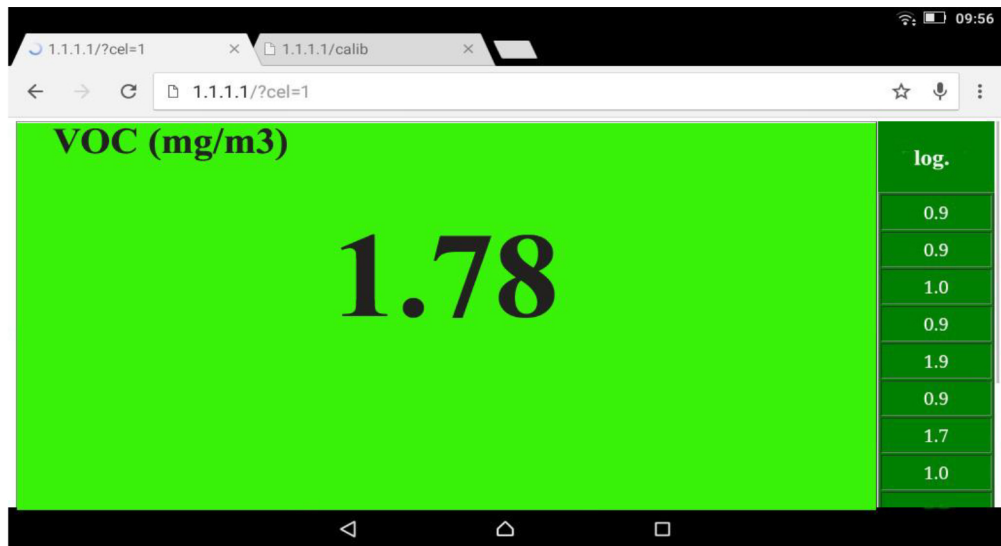

تصویر نمایشگر محلی



www.EHYAGRAN.ir
telegram: @Ehyagran_co
+98 915 1211239

Not secure | 192.168.1.106:88/zist_semnon/_9332044109__list.php?goto=173



Print this page Print all pages Advanced search Export results

search

Q

+

-

Details found: 17418 Page 173 of 175 Records Per Page: 100

Logged on as zist

Log out

1) Asad shimie (VOC ug/m3) 09398843687

2) Gheermehre parsian (VOC ug/m3) 09398843668

3) Rasabaam (VOC ug/m3) 09398843717

4) Tehranoil (VOC ug/m3) 09398843654

5) MEHRBAAM PALAYESH VOC(ppm)09398843697

6) Petro farzan (VOC ug/m3) 09398843622

7) Aali pardazan (VOC ug/m3) 09398843685

8) Azarbaam koomesh (VOC ug/m3) 09398843642

Date Time	VOC	ANT	Rls	Lat	Lon
960612_00:15	0.10	14.00	100.00	32.199516	51.839832
960612_00:00	0.05	14.00	100.00	32.199516	51.839832
960611_23:30	0.05	13.00	100.00	32.199516	51.839832
960611_23:15	0.10	13.00	100.00	32.199516	51.839832
960611_22:15	0.05	12.00	100.00	32.199516	51.839832
960611_22:00	0.05	14.00	100.00	32.199516	51.839832
960611_21:45	0.05	14.00	100.00	32.199516	51.839832
960611_21:30	0.05	14.00	100.00	32.199516	51.839832

تصویر روی اینترنت